

# BY2671

## 绝缘电阻测试仪

### 尊敬的顾客

感谢您购买本公司 BY2671 绝缘电阻测试仪。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。



我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！



### 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

为了防止火灾或人身伤害，只有合格的技术人员才可执行维修。

**使用适当的电源线。**只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

**正确地连接和断开。**当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

**产品接地。**本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

**注意所有终端的额定值。**为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对

本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

——安全术语

**警告：**警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

**小心：**小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

## 目 录

一、概述.....	4
二、技术指标.....	4
三、面板示意图.....	5
四、使用方法.....	6
五、维护保养及注意事项.....	6
六、售后服务.....	6


## 一、概述

### 1、仪表工作原理

BY2671 绝缘电阻测试仪由中大规模集成电路组成。本表输出功率大，短路电流值高，输出电压等级多（每种机型有四个电压等级）。工作原理为由机内电池作为电源经 DC/DC 变换产生的直流高压由 E 极出经被测试品到达 L 极，从而产生一个从 E 到 L 极的电流，经过 I/V 变换经除法器完成运算直接将测得的绝缘电阻值由 LCD 显示出来。

### 2、仪表电路框图

如图所示：

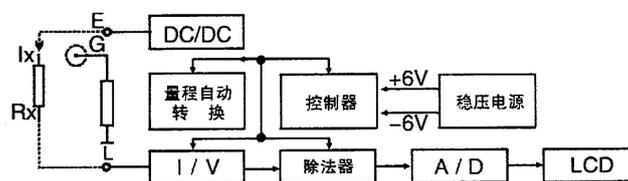

### 3、仪表使用范围

本仪表是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。

### 4、仪表特点

本表具有以下特点：

输出功率大、带载能力强，抗干扰能力强。

本表外壳由高强度铝合金组成，机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器，对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。

## 二、技术指标

### 1、使用条件

环境温度：0℃~+45℃流可直接测量，不需带载测量进行估算。

相对湿度：≤85%

### 2、输出电压等级、测量范围、分辨率、误差

机 型	输出电压等级	测量范围	相对误差	分 辨 率
2671	500V,1000V 2000V,2500V	0~19999 MΩ	≤±10%±1d	0.01MΩ,0.1MΩ, 1.0MΩ,10.0MΩ

### 3、输出最高电压带载能力及短路电流


机 型	电压/负载	电压跌落	短路电流
2671	2500V/20MΩ	约 10%	>1.6mA

### 4、电源适用范围、功率损耗

直流：7~9V（6节5#镉镍可充电电池）外接交流 220V 电源。

功耗：静态功耗≤160mW；最大功率≤2.5W。

## 三、面板示意图

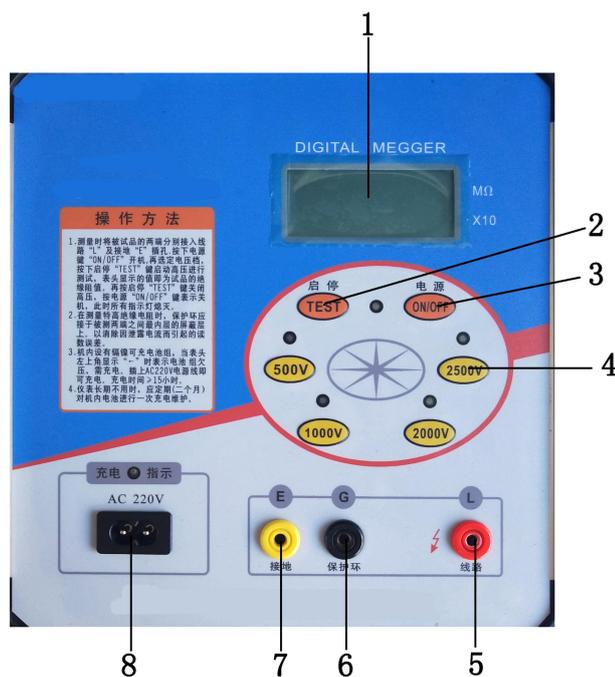

面板图（仅供参考，以实物为准）

- 1、显示屏：显示实测电阻值
- 2、启停按键：启动停止按键
- 3、电源按键：电源开关按键
- 4、量程按键：量程选择
- 5、线路：电压输出

- 6、保护环：屏蔽抗干扰接线端
- 7、接地：设备接地
- 8、电源插座：AC220V 电源输入

## 四、使用方法

### 1、测量步骤

开启电源开关“ON”，选择所需电压等级，轻按一下指示灯亮代表所选电压档，轻按一下高压启停键，高压指示灯亮，LCD 显示的稳定数值即为被测的绝缘电阻值，关闭高压时只需再按一下高压键，关闭整机电源时按一下电源“OFF”

2、启动高压后，机内定时器开始工作，此时数值被锁定，便于计算吸收比。

### 3、接线端子符号含义

测量绝缘电阻时，线路“L”与被测物同大地绝缘的导电部分相接，接地“E”与被测物体外壳或接地部分相接，屏蔽“G”与被测物体保护遮蔽部分相接或其他不参与测量的部分相接，以消除表泄漏所引起的误差。测量电气产品的元件之间绝缘电阻时，可净“L”和“E”端接在任一组线头上进行。如测量发电机相间绝缘时，三组可轮流交换，空出的一相应安全接地。

## 五、维护保养及注意事项

1、存放保管本表时，应注意环境温度和湿度，放在干燥通风的地方为宜，要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。

2、被测物体为正常带电体时，必须先断开电源，然后测量，否则会危及人身设备安全！本表 E、L 端子之间开启高压后有较高的直流电压，在进行测量操作时人体各部分不可触及。

3、本仪表配有电池组。当机内电池组电压低于 7.2V 时，表头左上角显示欠压符号“←”。提示要及时更换电池组，仪表长期不用时，应取下电池组。

## 六、售后服务

仪器自购买之日起一年内，属于公司的产品质量问题免费维修，终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案，并为您提供最快的现场服务。



